

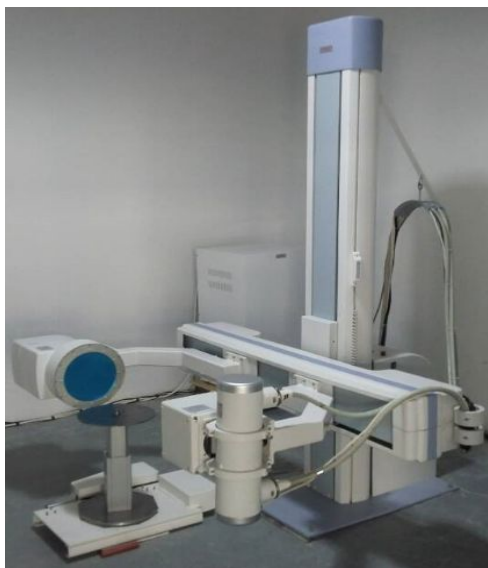
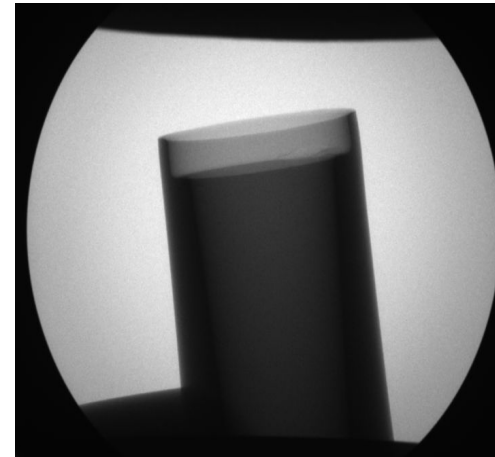
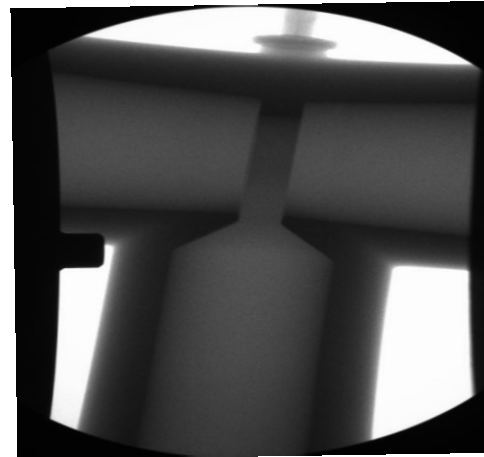
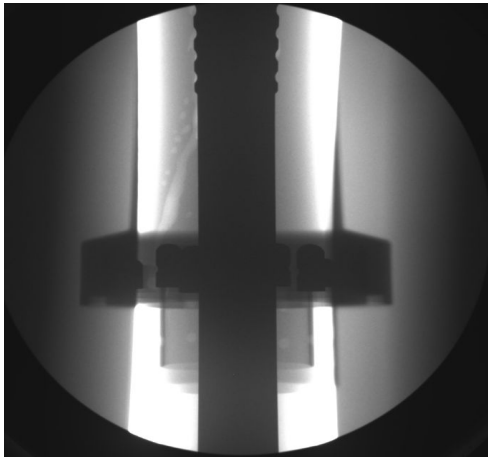
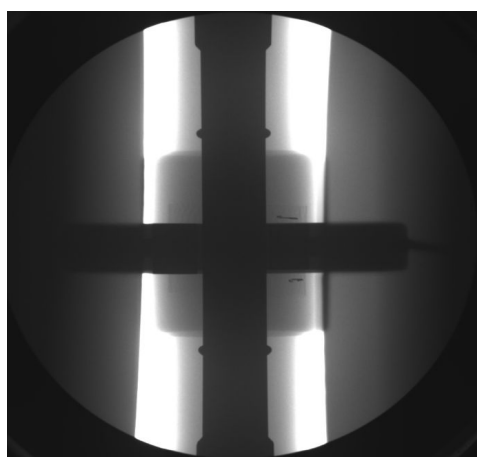
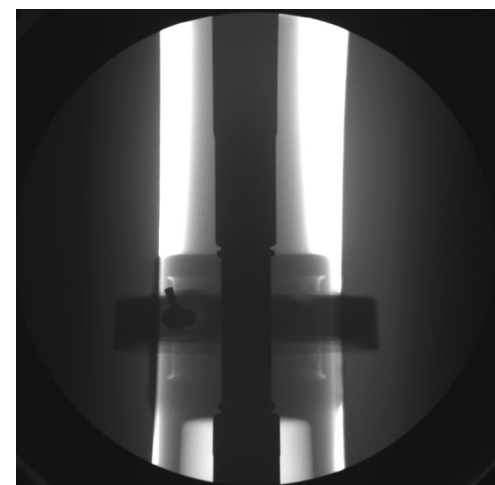
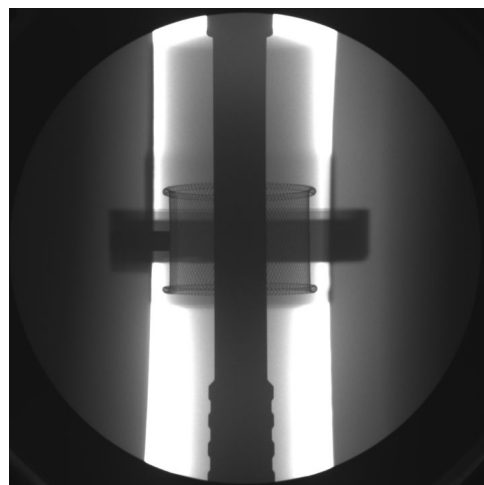


高压电缆附件 工业无损检测 数字化 X 光机

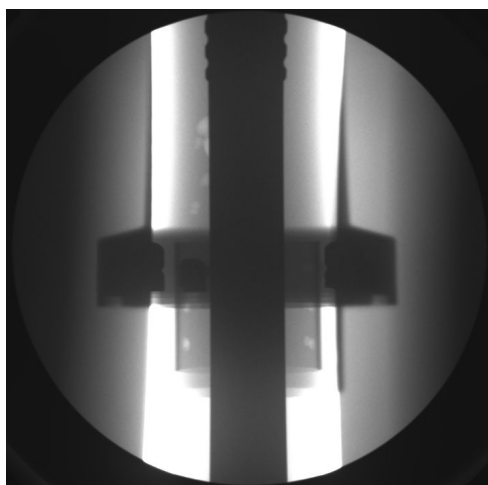

产品名称	参 数
电源条件	三相交流 380V $\pm$ 22V 电源容量 $\geq$ 30KVA
高压发生器	数字高频高压发生装置： $\geq$ 50KW 透视管电压：手动 40~110kV，自动 40~110kV 可调 透视管电流：手动 0.3~6mA，自动 0.3~6mA 可调 透视和摄影分别可调： 透视管电压调节范围： $\geq$ 40~110kV 透视管电流调节范围： $\geq$ 0.3~6mA，连续调节 摄影管电压调节范围：40~125KV 摄影管电流调整范围：50mA~500mA
X 线管组件	高频独立机头，非组合式机头，可以连续长时间使用。球管阳极热容量 $\geq$ 200KHU
影像系统	影像增强器 $\geq$ 9 寸金属屏，中心分辨率 $\geq$ 48 lp/mm 整机分辨率： $\geq$ 12 LP/cm
数字相机	类 型：黑白, 逐行； 感光器件：CCD, 2/3"; A/D:12bit； 分辨率：1024 $\times$ 1024。
测试台	旋转测试台

珠海客户产品测试效果图


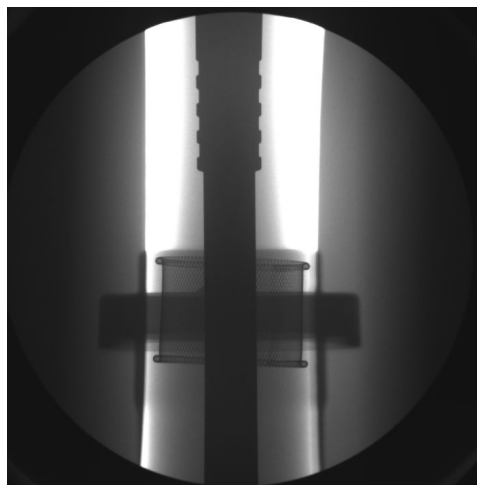


Newheek

珠海客户现场及产品图片





深圳客户产品测试效果图1

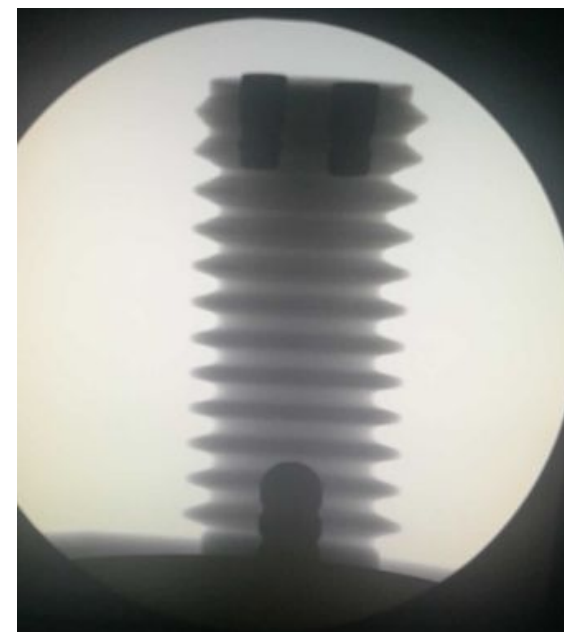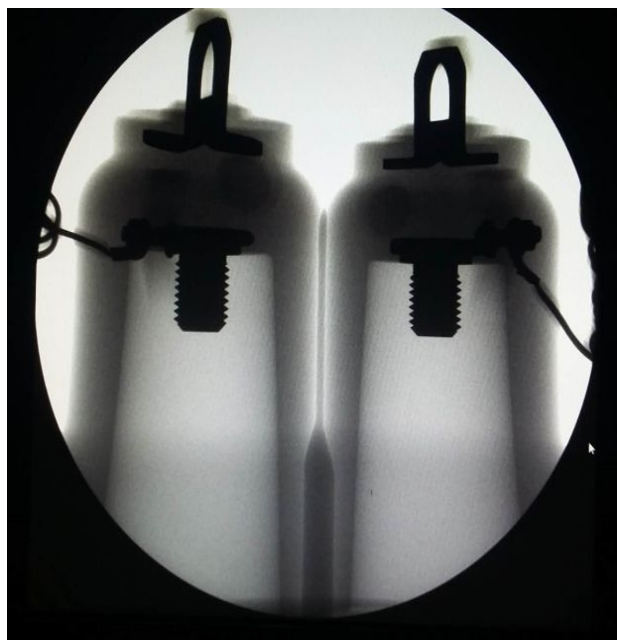

上述 3 幅图是合格的产品图片

深圳客户产品测试效果图2

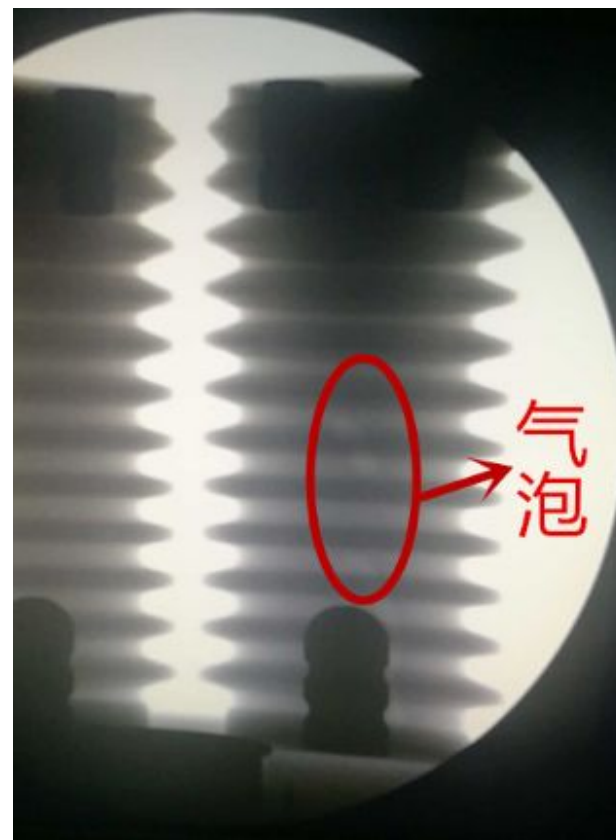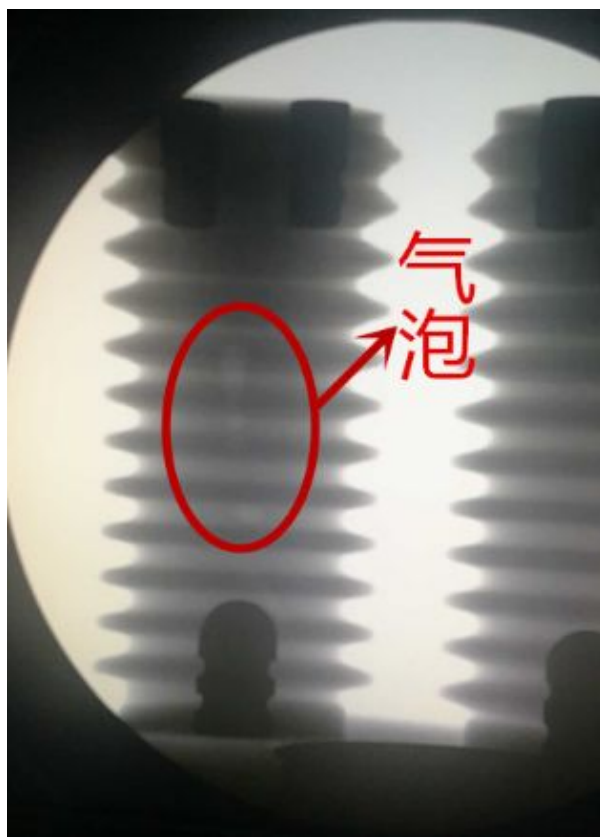

上述 2 幅图是检测出内部有气泡的不合格产品图片

深圳客户现场及产品图片

